


## Erklæring om samsvar

### Overensstemmelse med spesifikasjon

De følgende sidene inneholder kalibreringsresultatene og indikerer instrumentets ytelse i forhold til de angitte spesifikasjonene. For å bestemme samsvar med spesifikasjonene ble retningslinjene for ILAC-G8: 09/2019 brukt som referanse.

Måleusikkerhet på kalibreringstidspunktet er gitt der det er aktuelt. Måleusikkerhet beregnes i samsvar med EA-4/02. Den rapporterte utvidede usikkerheten til målingen er oppgitt som standard måleusikkerhet multiplisert med en dekningsfaktor  $k = 2$ , som tilsvarer en deknings sannsynlighet på omtrent 95%.

### Beslutningsregler

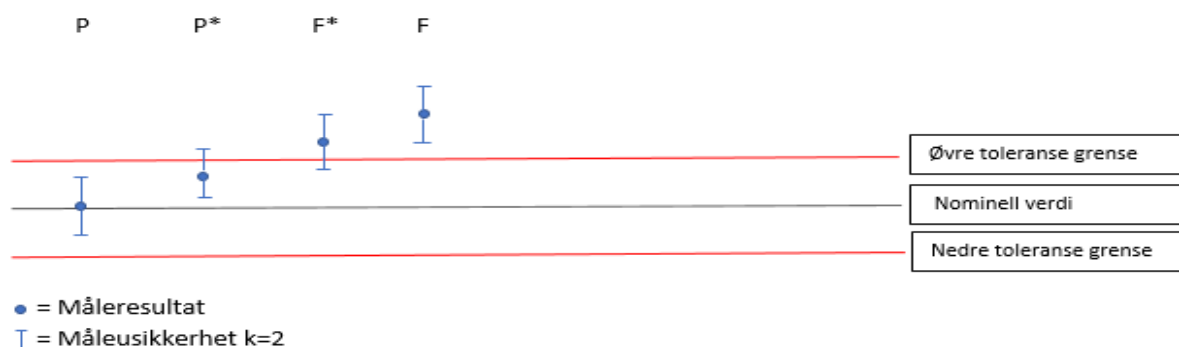

Indikator	Forklaring
P (Pass)	Utstyret samsvarer med den oppgitte spesifikasjonen ved de målte punktene, idet det er tatt hensyn til måleusikkerhet, hvis denne er tilgjengelig.
P* (Pass*)	Måleresultatet er innenfor spesifikasjonsgrensen med en margin mindre enn måleusikkerheten. Det er derfor ikke mulig å oppgi samsvar basert på det oppgitte konfidens intervall. Resultatene indikerer imidlertid at samsvar er mer sannsynlig enn at det er manglende samsvar med spesifikasjonsgrensen.
F* (Fail*)	Måleresultatet er utenfor spesifikasjonsgrensen med en margin mindre enn måleusikkerheten. Det er derfor ikke mulig å oppgi samsvar basert på det oppgitte konfidens intervall. Resultatene indikerer imidlertid at det er mer sannsynlig at det er manglende samsvar enn at det er samsvar med spesifikasjonsgrensen.
F (Fail)	Utstyret samsvarer ikke med den oppgitte spesifikasjonen på de målte punktene, også med tanke på måleusikkerhet, hvis denne er tilgjengelig.